



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.พร. (โทร. ๔๑๔๐๙)

ที่ พร.เลขรับ ๖๑๙๑/๖๘

วันที่ ๖๔ เม.ย. ๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุสายแพทย์ที่จะขายทอดตลาด

เสนอ พร.

๑. คณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาด รายงานผลการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุสายแพทย์ชำรุด จำนวน ๑ รายการเพื่อขายทอดตลาด รายละเอียดตามบันทึก คณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุด ที่ ต่อ พร.เลขรับ ๖๑๙๑/๖๘ ลง ๒๓ เม.ย. ๖๘

๒. กบ.พร.ขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

๒.๑ ตามที่ ทร. ได้อนุมัติจำหน่ายบัญชีพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีขายนั้น ทร.อนุมัติให้ขายโดยวิธีขายทอดตลาด และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาด ตามอนุมัติ พร. ลง ๓ เม.ย. ๖๘ ท้ายบันทึก แผนกควบคุม กสพ.พร. ที่ กท ๐๕๒๙.๗.๔/๔๗ ลง ๒๗ มี.ค. ๖๘ เลขรับ พร. ๖๑๙๑/๖๘

๒.๒ คณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาดได้ตรวจสอบสภาพพัสดุสายแพทย์ชำรุดแล้วรายงาน ว่า พักชำรุดส่วนใหญ่เป็น เหล็ก อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับซื้อพัสดุชำรุด (รีไซเคิล) แล้ว จึงกำหนดราคากลางเป็นมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบันทึกที่อ้างในข้อ ๑

๓. ผอ.พร. พิจารณาแล้ว พักชำรุดชำรุดทั้ง ๑ รายการ ทร. ได้อนุมัติให้จำหน่ายแล้ว โดยวิธีการขาย พร.จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาด โดยคณะกรรมการฯ ประเมินราคากลางรวมเป็นมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผอ.พร.ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพัสดุ ดังนั้น จึงสมควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบและอนุมัติราคากลางฯ ตามที่คณะกรรมการประเมินสภาพฯ เสนอ

๓.๒ ให้ผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุสายแพทย์ชำรุด

๓.๒.๑ น.ต.หญิง พนารัตน์ รุ่งสว่าง เป็นประธานกรรมการฯ

๓.๒.๒ ร.ท.หญิง วิชุดา ดั่งมั่ง เป็นกรรมการฯ

๓.๒.๓ ร.ท.วิสุทธิ ประจิตร เป็นกรรมการฯ

๓.๓ ให้ออกประกาศขายทอดตลาด และติดประกาศขายทอดตลาด ดังนี้

๓.๓.๑ กวส.พร.เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดฯ ที่ www.nmd.go.th

๓.๓.๒ กสพ.พร. ติดประกาศขายทอดตลาดไว้ที่บอร์ดหน้าอาคารของหน่วยงานและ

เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ กำหนดตรวจดูพัสดุชำรุด ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๘ (ในวันราชการ) เวลา ๑๑๐๐ เป็นต้นไป และทำการขายทอดตลาดในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๘ เวลา ๑๑๐๐ เป็นต้นไป

๓.๕ ให้ กก.พร. จัดเจ้าหน้าที่รับเงินหลักประกันฯ และรับเงินจากการขาดทอดตลาด

๔. เห็นควร...

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๓


๔.๒ ให้ แผนกธุรการ บก.พร. สำเนาบันทึกและประกาศฯ (พร้อมเอกสารที่แนบทั้งหมด) ให้ กวส.พร. กกง.พร. และกบ.พร. ส่วนต้นเรื่องทั้งหมดให้ กสพ.พร. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔ และลงนามในร่างประกาศ ขยายทอดตลาดที่แนบ


ว่าที่ น.ท.


รอง หก.กบ.พร. ทำการแทน
หก.กบ.พร.

น.อ.


หน.นฝอ.พร.
๖๘ เม.ย.๖๘


พล.ร.ต.


รอง จก.พร. (๒)
๒๙ เม.ย.๖๘

- อนุมัติตามข้อ ๔

- ลงนามแล้ว


พล.ร.ท.



จก.พร.

๒๙ เม.ย.๖๘

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท. 

(พิพัฒชัย เชื่อมไธสง)

ช่วยปฏิบัติราชการ แผนกธุรการ บก.พร.

๒ พ.ค.๖๘



บันทึกข้อความ

กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ ๑๓๕๐
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๑๘ ย.

ส่วนราชการ คณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางฯ (โทร.๕๒๖๗๓)

ที่ ต่อ พร.เลขรับ ๖๑๙๑/๖๘ วันที่ ๒๓ เม.ย.๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินสภาพพัสดุสายแพทย์ที่อนุมัติจำหน่ายบัญชีแล้วและประเมินราคากลาง

เสนอ กสพ.พร.


๑. ตามอนุมัติ พร. ลง ๓ เม.ย.๖๘ ท้ายบันทึก แผนกควบคุม กสพ.พร. (โทร. ๕๑๕๐๙) ที่ กท ๐๕๒๙.๗.๔/๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๖๘ แต่งตั้งให้กระผม ว่าที่ น.ท.ประสิทธิ์ ศรีสรรค์วิรัช พร้อมด้วย ร.ท.ชำนาญ พลายพุ่มไม้ และ ว่าที่ ร.ท.ไพรัตน์ คำหอม เป็นคณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุสายแพทย์ชำรุดที่จะขายทอดตลาด จำนวน ๑ รายการ นั้น ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๒. การตรวจสอบสภาพพัสดุชำรุดสายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เป็น เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง สภาพของพัสดุโดยทั่วไปชำรุด ไม่มีสภาพคงเดิมและไม่สามารถใช้ราชการได้


๓. การประเมินราคากลางจากสภาพของพัสดุชำรุดสายแพทย์ ดังกล่าว ตามข้อ ๒. ส่วนใหญ่เป็นเหล็ก อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการสืบราคา จากผู้มีอาชีพรับซื้อพัสดุชำรุด (รีไซเคิล) ในท้องตลาดสมควรกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางพัสดุสายแพทย์ชำรุด ตามข้อ ๓. เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ น.ท.  ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ ศรีสรรค์วิรัช)

ร.ท.  กรรมการ

(ชำนาญ พลายพุ่มไม้)

ว่าที่ ร.ท.  กรรมการ

(ไพรัตน์ คำหอม)

คณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางฯ

- กนท
๒๔ เม.ย. ๖๘

กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ ๑๕๔๓
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐๐๐

กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ ๑๑๙๑
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๒๐๓๐

กองส่งกำลังสายแพทย์ พร.
เลขรับ ๑๕๓
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓๐๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกควบคุม กสพ.พร. (โทร. ๔๑๔๐๙)

ที่ กท ๐๕๒๙.๗.๔/๔๗

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่อนุมัติจำหน่ายบัญชีแล้ว ซึ่งได้รับมา
ด้วยการจัดซื้อจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

เสนอ กสพ.พร.

๑. ทร. อนุมัติจำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการขาย
รายละเอียดตาม อนุมัติ ทร. (รอง ผบ.ทร. รับคำสั่ง ผบ.ทร.) ท้ายบันทึก กบ.ทร.(สกบ. โทร.๕๔๙๗๕)
ที่ต่อ กบ.ทร.เลขรับ ๗๐๗๑/๖๗ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๗ ที่แนบ

๒. แผนกควบคุม กสพ.พร. ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ตามอนุมัติในข้อ ๑ ทร./จก.พร. แจ้งว่าเมื่อ ทร. อนุมัติจำหน่ายแล้วให้
รพ.อภากาศเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ดูแลเก็บรักษาครุภัณฑ์ไว้เพื่อรอการดำเนินการขายทอดตลาดจาก พร.
และให้ พร. ดำเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๕(๑)

๒.๒ แผนกควบคุม กสพ.พร. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป
ทะเบียนฯ ๒๔๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาสภาพจาก กอง สน.พร. เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามผนวก) ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ข้อ ๒๑๕(๑) เมื่อได้ดำเนินการขายเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๑๖ โดยนำเงินที่ได้จากการขายส่ง
กง.ทร. เพื่อนำส่งเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และข้อ ๒๑๘ โดยลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที
แล้วแจ้งให้ สตง.ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

๓. เพื่อให้การดำเนินการ ตามข้อ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอ พร. ดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้ขาย โดยวิธีการขายทอดตลาด ผู้ชนะการประมูลต้องไปรับครุภัณฑ์
ที่ รพ.อภากาศเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง และคณะกรรมการขายทอดตลาด

๓.๓ เงินที่ได้จากการขายให้นำส่ง กง.ทร.

๓.๔ แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ว่าที่ น.อ.



ปฏิบัติหน้าที่ หน.ควบคุม กสพ.พร.

เสนอ พร. /

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. 

ผอ.กสพ.พร.
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

กบ.พร.
๒๕ มิ.ย. ๖๕

เสนอ พร.

๑. กสพ.พร. (แผนกควบคุมฯ) เสนอขออนุมัติดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุสายแพทย์ชำรุด ซึ่งได้รับอนุมัติจำหน่ายบัญชีแล้วโดยวิธีขาย จำนวน ๑ รายการ (๑ หน่วยนับ) รายละเอียดตามบันทึก แผนกควบคุม กสพ.พร. ที่ กท ๐๕๒๙.๗.๔/๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๖๘

๒. กบ.พร.ขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุดังกล่าวมีความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการขาย โดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม

๒.๒ การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๗ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ ขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุมักมีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถื่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่ทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตาม ความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา ให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้าง ผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

๓. ผอ.พร. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของราชการ และประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้ดำเนินการขายพัสดุสายแพทย์ชำรุดตามข้อ ๑ โดยวิธีขายทอดตลาด

๓.๒ ให้ผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการประเมินสภาพและกำหนดราคากลางพัสดุชำรุด ที่จะขายทอดตลาด โดยดำเนินการตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๓.๒.๑ ว่าที่ น.ท.ประสิทธิ์ ศรีสรรค์วิรัช เป็นประธานกรรมการฯ

๓.๒.๒ ร.ท.ชำนาญ พลายนุ่มไม้ เป็นกรรมการฯ

๓.๒.๓ ว่าที่ ร.ท.ไพรัตน์ คำหอม เป็นกรรมการฯ


๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๓

๔.๒ ให้ แผนกธุรการ กบ.พร. สำเนาบันทึก แผนกควบคุม กสพ.พร.พร้อมเอกสารทั้งหมด ให้ กบ.พร. ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต้นเรื่องทั้งหมดให้คณะกรรมการตามข้อ ๓.๒ ดำเนินการต่อไป


จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

น.อ.




ทก.กบ.พร.

น.อ.



ทน.นผอ.พร.

๒ เม.ย.๖๘

พล.ร.ต. 

รอง จก.พร. (๒)

๒ เม.ย.๖๘

- อนุมัติตามข้อ ๔

รับคำสั่ง จก.พร.

พล.ร.ท. 

จก.พร.

๓ เม.ย.๖๘

พ.ร.๑๖๖๕๕/๖๗



บันทึกข้อความ

กองส่งกำลังสายแพทย์ พร.
เลขรับ ๑๐๗
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐

ส่วนราชการ บก.พร. (กบ. โทร. ๕๒๖๕๑)

ที่ กท.๐๕๒๕.๑.๕/๕๐

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ทร. อนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์สายแพทย์

แผนกควบคุม กสพ.พร.
เลขรับ ๑๖
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐

เสนอ พร.

๑. ทร. อนุมัติจำหน่ายบัญชีเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ของแผนกรังสี กองรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. จำนวน ๑ เครื่อง ตราอักษร SHIMADZU รุ่น/แบบ UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ รหัสทะเบียนฯ ๒๕๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีขาย ตามอนุมัติ ทร. (รอง ผบ.ทร. รับคำสั่ง ผบ.ทร.) ท้ายบันทึก กบ.ทร. ที่ ต่อ กบ.ทร. เลขรับ ๗๐๗๑/๖๗ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๗

๒. กบ.พร. ขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการขายพัสดุที่จำหน่ายแล้วตามข้อ ๒๑๕ (๑) และให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการขายตามข้อ ๒๑๖ จากนั้นให้ลงจ่ายพัสดุนอกจากบัญชีหรือทะเบียนตามข้อ ๒๑๘ และให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการขายตามมาตรา ๑๕ ของข้อบังคับทหารว่าด้วยการขายพัสดุของหลวง พุทธศักราช ๒๔๙๐

๒.๒ ตามอนุมัติในข้อ ๑ ทร. สั่งการให้ พร.ดำเนินการขายทอดตลาด สำหรับเงินที่ได้จากการขายให้นำส่งเป็นเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมทั้งออกจากระบบ New GFMS Thai กับระบบ IAS แล้วแจ้ง สตง. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงจ่ายครุภัณฑ์ และให้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. นำครุภัณฑ์ฯ ส่งคืน พร. ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันได้รับเรื่องอนุมัติจำหน่าย และลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วย

๓. ผอ.พร.พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ขอให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ประสานแผนกควบคุม กสพ.พร. โทร. ๔๑๔๐๙ เพื่อนำครุภัณฑ์ดังกล่าวส่งคืน กสพ.พร. แล้วลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนของหน่วย รวมทั้งระบบ NMD e Supply

๓.๒ กสพ.พร. แยกครุภัณฑ์ออกตามประเภทเงินการได้มา หรือการนำเงินส่งของ กกง.พร. (ข้อ ๓.๓) แล้วดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในข้อ ๒๑๕ (๑) เมื่อดำเนินการแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๑๖ แล้วนำเงินที่ได้จากการขายส่ง กกง.พร. และข้อ ๒๑๘ โดยลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี/ทะเบียนของ พร. และระบบ New GFMS Thai กับ IAS แล้วรายงานผลตัด/จ่ายบัญชีให้ พร. แจ้ง สตง. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงตัด/จ่ายออกจากบัญชี รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์หรือศูนย์ต้นทุน

๓.๓ กกง.พร. นำเงินที่ได้จากการขายส่งเข้าเป็นเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินทรัพย์

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบการอนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ตามข้อ ๑ และให้ดำเนินการตามข้อ ๓

๔.๒ ให้แผนกธุรการ บก.พร. สำเนาบันทึกนี้ และอนุมัติ ทร. ให้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. กกง.พร. และ กบ.พร. ส่วนต้นเรื่องส่ง กสพ.พร.

๒๑/๒/๖๕

จึงเสนอมา...

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔


น.อ. 

ทก.กบ.พร.

น.อ. 

ทน.นผอ.พร.


๑๑ ม.ค.๖๘

พล.ร.ต. 

รอง จก.พร. (๒)

๑๐ ม.ค.๖๘

- อนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท. 

จก.พร.

 ม.ค.๖๘

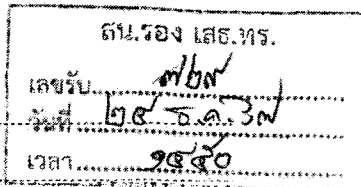
ส่ง นายจก.พร.

คำวินิจฉัย

น.อ. 

คส.กบ.พร.

๑๗ ม.ค. ๒๕๑๑



২১. ১৬৬০০/০০

๒.๖ การอนุมัติ ...

๒.๖ การอนุมัติจำหน่ายพัสดุในราคาซื้อหรือได้มาต่อหน่วยนับเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในอำนาจ รอง ผบ.ทร. ตามคำสั่ง ทร. ที่ ๙/๒๕๖๗ ลง ๑๗ ม.ค.๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพบเรือ ที่ ๑๘๘/๒๕๖๖ หมวด ก ข้อ ๔ ลำดับ ๕๕.๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

๓. กบ.ทร.พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์สาย พร. ในครั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ครบถ้วนแล้ว การชำรุดเสื่อมสภาพเป็นไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งเกินเกณฑ์อายุควบคุมทรัพย์สิน ประกอบกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วพบว่า ไม่คุ้มค่าในการซ่อมทำตามข้อ ๒.๑ รวมทั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบแล้ว มิได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จึงไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบหรือชดใช้ทางละเมิด ตามข้อ ๒.๒ สำหรับวิธีการจำหน่ายนั้น พร.พิจารณาแล้วครุภัณฑ์ดังกล่าว ชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้ราชการมานาน จึงไม่สามารถจำหน่ายโดยวิธีโอนเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ราชการหรือประโยชน์อื่นใดได้ อีกทั้งเป็นครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเฉพาะทาง มีความล้าสมัย และมีมูลค่าคงเหลือไม่เพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนกับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน จึงไม่สามารถจำหน่ายโดยวิธีแลกเปลี่ยนได้ การจำหน่ายโดยวิธีขาย จึงนับว่า เป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ซึ่ง กบ.ทร.เห็นพ้องด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้ พร.จำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ทรอักขร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E หมายเลขเครื่อง 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้ราชการที่แผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ออกจากบัญชี โดยวิธีขาย ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. ตามข้อ ๒.๖

๓.๒ เพื่อให้การจำหน่ายครุภัณฑ์ ตามข้อ ๓.๑ เป็นไปตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อ ทร.อนุมัติให้จำหน่ายแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ ให้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.ดำเนินการนำครุภัณฑ์ดังกล่าว ส่งให้ พร. ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องการอนุมัติจำหน่าย และลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียนครุภัณฑ์สาย พร.


๓.๒.๒ ให้ พร.ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๕ (๑) ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่อนุมัติจำหน่าย สำหรับเงินที่ได้จากการขายให้นำส่งเข้าบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.ต่อไป ตามข้อ ๒.๓ - ๒.๕ หากดำเนินการขายแล้วไม่ได้ผลดี ให้ดำเนินการแปรสภาพหรือทำลาย และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียนครุภัณฑ์สาย พร. พร้อมทั้งลงจ่ายออกจากระบบ New GFMS Thai และระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (IAS) กับแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายครุภัณฑ์นั้น ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๘

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติให้ พร.จำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ทรอักขร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E หมายเลขเครื่อง 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้ราชการที่แผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ออกจากบัญชี โดยวิธีขาย ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้ พร. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท. 

จก.กบ.ทร.

สำเนาส่ง

สลก.ทร. สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) กบ.ทร. (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สปช.ทร. พร. (ต้นเรื่อง) รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส

เสนอ

เห็นควร อนุมัติให้ พร.จำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตรายี่ห้อ SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E หมายเลขเครื่อง 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๔๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้ราชการที่แผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ จุฬ.สส. ออกจากบัญชี โดยวิธีขาย กับให้ดำเนินการตามที่ กบ.ทร.เสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. โดยการรับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.ท.

รอง เสธ.ทร.ทำการแทน

เสธ.ทร.

๖๗ ธ.ค.๖๗

- อนุมัติ

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.อ.

รอง ผบ.ทร.

๓ ม.ค.๖๘

- กบ.ทร.
ท
ผู้สั่ง



บันทึกข้อความ

399

ส่วนราชการ พร. (นภ. โทร. ๕๒๖๕๑)

ที่ กท.๐๕๒๙.๑/๑๙๒๗

วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์สายแพทย์

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
เลขรับ ๓๐๗๖
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา ๐๗.๕๐

กองการส่งกำลังและวัสดุการ คบ.พร.
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา ๐๗.๕๐

เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.พร.)

๑. ขออนุมัติจำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ของแผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. จำนวน ๑ เครื่อง ตราอักษร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ ทะเบียนฯ ๒๕๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑

๒. พร. ขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ ซื้อด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ฯ มีอายุใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี พร.กำหนดอายุใช้งานไว้ ๕ ปี เนื่องจากชำรุด หน่วยได้ประสานห้างหุ้นส่วนสามัญ เค.ที.เมติคอล มีเดีย เพื่อเข้าซ่อมทำ ทางห้างหุ้นส่วนฯ เสนอราคาซ่อมทำ ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมูลค่าซ่อมทำค่อนข้างสูง หน่วยจึงเสนอขอรับการซ่อมทำต่อ พร. ซึ่ง พร.ได้เสนอให้ กอง สน.พร. พิจารณาดำเนินการ กอง สน.พร.ได้ทำการ ตรวจสอบแล้วพบว่า มีสภาพชำรุดมาก และมีอายุการใช้งานมานานเกินที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้าน เศรษฐศาสตร์พบว่า ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมทำ ซึ่งสุดท้ายก็จะซ่อมทำให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จึงเสนอขอยกเลิก การซ่อมทำ ตามบันทึก กอง สน.พร. ที่ กท.๐๕๒๙.๑๓/๓๘๗ ลง ๒ ส.ค.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ พร. ได้ยกเลิกการซ่อมทำ ตามอนุมัติ พร. ท้ายบันทึก บก.พร. ที่ กท.๐๕๒๙.๑.๕/๘๐๑ ลง ๒๗ ส.ค.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามอนุมัติ รพ.ฯ ท้ายบันทึก แผนกส่งกำลังบำรุงฯ ที่ ต่อ รพ.ฯ เลขรับ ๑๐๑๖๐/๖๗ ลง ๓ ก.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๔ คณะกรรมการฯ รายงานว่า ชำรุดเกิดจากการปฏิบัติราชการ ไม่มีผู้ใดกระทำให้เกิดความเสียหาย สมควรดำเนินการจำหน่ายบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ ต่อ รพ.ฯ เลขรับ ๑๐๑๖๐/๖๗ ลง ๑๒ ก.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๕ การจำหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในข้อ ๒๑๕ ถึงข้อ ๒๑๙ ของระเบียบฯ และระเบียบ ทร.ว่าด้วยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ ในข้อ ๓๐ ของระเบียบฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายพัสดुरาคาซื้อหรือได้มาต่อหน่วยนับตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ ยกเว้นเครื่องสรรพากร ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการสรรพากร พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบอำนาจให้ รอง ผบ.ทร. เป็นผู้อนุมัติ จำหน่าย ตามคำสั่ง ทร. ที่ ๙/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทร. ที่ ๑๘๘/๒๕๖๖ ลง ๑๗ ม.ค.๖๗ ผนวก ก ข้อ ๔ ลำดับ ๕๕๔

๒.๖ ข้อบังคับทหาร...

๒.๖ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการขายพัสดุของหลวง พุทธศักราช ๒๔๕๐ มาตรา ๑๕ เมื่อขายพัสดุเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ขายปฏิบัติดังนี้ ๑) จำหน่ายบัญชี หากพัสดุนั้น ๆ มีบัญชีคุมอยู่หน่วยอื่น ก็ให้แจ้งขอจำหน่ายไปยังหน่วยนั้น ๆ ด้วย ๒) จัดการเรื่องเงิน คือ ก. ถ้าพัสดุนั้นจัดหามาด้วยเงินนอกงบประมาณ ก็ให้นำเงินที่ขายได้ส่งเพิ่มไว้ในเงินประเภทนั้น ๆ ข. ถ้าพัสดุนั้นจัดหามาด้วยเงินงบประมาณประจำปีของกระทรวงกลาโหมแล้วเงินที่ขายได้ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น ค. ถ้าพัสดุนั้นได้มาโดยมีผู้บริจาคนำเงินที่ขายได้ส่งเข้าเป็นเงินบำรุงหน่วย เว้นแต่จะมีระเบียบการเป็นอย่างอื่นก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบนั้น

๓. พร. พิจารณาล้างหนี้

๓.๑ ครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ มีอายุการใช้งานมานานเกินเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าได้ใช้งานมาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบแล้วว่า มีสภาพชำรุดมาก และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมทำ ซึ่งสุดท้ายก็จะซ่อมทำให้ได้ตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ พร.จึงยกเลิกการซ่อมทำ และหน่วยได้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการฯ รายงานว่า ชำรุดเกิดจากการปฏิบัติราชการ ไม่มีผู้ใดกระทำให้เกิดความเสียหายสมควรดำเนินการจำหน่ายบัญชีตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติให้พร.จำหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์สายแพทย์โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายละเมิด โดยการอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร.

๓.๒ สำหรับวิธีการจำหน่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการนั้น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุดมาก ที่มีอายุใช้งานมานาน และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมทำ จึงไม่สามารถจำหน่ายโดยวิธีการโอนให้หน่วยงานอื่นใดได้ อีกทั้งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้งานเฉพาะทางและมีมูลค่าคงเหลือไม่เพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนกับครุภัณฑ์ในประเภทและชนิดเดียวกัน จึงไม่สามารถจำหน่ายโดยวิธีแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้น การจำหน่ายโดยวิธีขาย จึงนับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติให้ พร. จำหน่ายโดยวิธีขาย

๓.๓ เมื่อได้รับการอนุมัติจำหน่ายโดยวิธีขายแล้ว ให้ พร.ดำเนินการขายทอดตลาด โดยเมื่อขายเรียบร้อยแล้วให้นำเงินที่ได้จากการขายส่งเข้าเป็นเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. และให้ลงจ่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวออกจากบัญชี/ทะเบียนของหน่วย รวมทั้งลงจ่ายออกจากระบบ New GFMS Thai กับระบบ IAS ทันที แล้วแจ้ง สดง. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงตัดจ่าย

๔. เห็นควร

๔.๑ จำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ โดยวิธีขาย

๔.๒ ให้ พร. ดำเนินการตามข้อ ๓.๓

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ต.



รอง จก.พร. ทำการแทน

จก.พร.

พ.ร. ๒๖๙๙/๒๗



บันทึกข้อความ

กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทยทหารเรือ
เลขรับ..... ๕๖๓
วันที่..... ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๕.๐๖

ส่วนราชการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. (กบ. โทร ๗๓๐๕๕)

ที่ กท.๐๕๒๑๖/๒๐๗

วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

เสนอ พร.

๑. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. มีความประสงค์จะขออนุมัติจำหน่ายบัญชีเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตราอักษร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑จำนวน ๑ เครื่อง ใ้ราชการที่ แผนกรังสี ฯ เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้ราชการได้

๒. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์ตามข้อ ๑. รพ.ฯ จัดซื้อเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อายุการใช้งานประมาณ ๑๒ ปี สงซ่อมทำเนื่องจากชำรุด และ พร. อนุมัติยกเลิกการซ่อมทำ เนื่องจาก สภาพชำรุดมาก มีอายุการใช้งานมานานเกินเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดตามบันทึก บก.พ.ร. (กบ. โทร.๕๒๖๕๑) ที่ กท ๐๕๒๔.๑.๕/๘๐๑ ลง ๒๗ ก.ค.๖๗

๒.๒ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของการชำรุด ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า ครุภัณฑ์มีสภาพชำรุดมาก มีอายุใช้งานนานเกินเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีผู้ใดกระทำให้เกิดความเสียหาย (รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการฯ ที่แนบ) ซึ่ง รพ.ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการฯ เห็นสมควรจำหน่ายบัญชีโดยมีต้องมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายละเมิด

๒.๓ อุปกรณ์ตามข้อ ๑. จัดเป็นครุภัณฑ์สายแพทย์ ประเภท ๖๕๒๕ ได้แก่ เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในรังสีกรรม ทั้งที่ใช้ในการแพทย์ หัตถแพทย์และสัตวแพทย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ พร.

๓. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. จึงขออนุมัติจำหน่ายบัญชีเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตามข้อ ๑. ออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผอ.รพ.ฯ ทำการแทน

ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

(๓๒)
๗๕๖๗๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ (โทร. ๗๓๐๒๖)

ที่ ต่อ รพ.ฯ เลขรับ ๑๐๑๖๐/๖๗ วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการชำรุดของครุภัณฑ์

เสนอ รพ.อาคารเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

ตามอนุมัติ ผอ.รพ.ฯ ท้ายบันทึก แผนกส่งกำลังบำรุงฯ ที่ ต่อ รพ.ฯ เลขรับ ๑๐๑๖๐/๖๗ ลง ๓ ก.ย.๖๗ แต่งตั้งกระผม น.ต.พิพัฒน์ ทองลิ่ม พร้อมด้วย ร.อ.นที เครือวัลย์ และ ร.อ.ยุทธชัย สำนทอง เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการชำรุดของเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป จำนวน ๑ รายการ ออกจากทะเบียนคุม นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการชำรุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อกรุณาทราบดังนี้

๑. เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตราอักษร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ รพ.ฯจัดซื้อ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๕ ราคาเมื่อได้มา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อายุการใช้งานประมาณ ๑๒ ปี

๒. สภาพการชำรุดของครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ ดังนี้ ตามบันทึก กอง สน.พร. (แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่ กท ๐๕๒๔.๑๓/๓๘๗ เรื่อง ขอยกเลิกการซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป พบว่าเครื่องเอกซเรย์มีสภาพชำรุดมาก และมีอายุการใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๕ ปี ซ่อมทำไม่คุ้มค่า พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกการซ่อมทำ

๓. คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเห็นว่าสภาพการชำรุดตามข้อ ๒ เกิดจากการปฏิบัติราชการโดยไม่มีผู้ใดกระทำให้เกิดความเสียหายจริง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นสมควรดำเนินการจำหน่ายบัญชีต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.ต.

ประธานกรรมการ

ร.อ.

กรรมการ

ร.อ.

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกส่งกำลังบำรุง ฯ (โทร.๗๓๐๕๕)

ที่ ต่อ รพ. ฯ เลขรับ ๑๐๑๖๐/๖๗ วันที่ ๑ ก.ย. ๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

เสนอ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

๑. พร. (รอง จก.พร. รับคำสั่ง จก.พร.) อนุมัติให้ยกเลิกการซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตราอักษร SHIMADZU รุ่น UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๔๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ ใช้ราชการในหน่วย แผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ รพ. ฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้กระทำให้เกิดการชำรุดเสียหายที่ต้องรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายละเมิด แล้วรายงานผลให้ พร. ทราบ

๒. แผนกส่งกำลังบำรุง ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ รับทราบตามข้อ ๑.

๒.๒ ให้ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑. เสร็จแล้วรายงานให้ รพ. ฯ ทราบในโอกาสแรก

๒.๒.๑ น.ต.พิพัฒน์ ทองลิ้ม ประธานกรรมการ

๒.๒.๒ ร.อ.นที เครือวัลย์ กรรมการ

๒.๒.๓ ร.อ.ยุทธชัย สำนทอง กรรมการ

๒.๓ ให้ แผนกสารบรรณ ฯ สำเนาเรื่องให้ กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ฯ และผู้เกี่ยวข้องในข้อ ๒.๒.๒ - ๒.๒.๓ ทราบ เสร็จแล้วส่งต้นเรื่องให้ประธานกรรมการในข้อ ๒.๒.๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒.๑ และพิจารณาอนุมัติในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓

น.อ.
หน.ส่งกำลังบำรุง ฯ

น.อ.
รอง ผอ.รพ. ฯ
ก.ย. ๖๗

- อนุมัติ

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.
ก.ย. ๖๗

สำเนาแล้ว

5 / ก.ย. 67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.พร. (กบ. โทร. ๕๒๖๕๑)

ที่ กท.๐๕๒๙.๑๕/๙๐๑

วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๗

เรื่อง กอง.สน.พร. ขอยกเลิกการซ่อมทำครุภัณฑ์สายแพทย์

เสนอ พร.

รพ.อาคารเกียรติวงศ์ รพ.สส.
เลขรับ ๑๐๑๕๐
วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๕๗
แผนกส่งเอกสาร
เลขรับ ๒๓๕๗/๖๗
วันที่ ๓ ก.ย. ๖๗
เวลา ๑๑.๑๖

๑. กอง.สน.พร.ขอยกเลิกซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ของแผนกรังสี กองรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก รพ.อาคารเกียรติวงศ์ รพ.สส. จำนวน ๑ เครื่อง ตรายักร SHIMADZU รุ่น/แบบ UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับไว้เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ ทะเบียนฯ ๒๔๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ ตามบันทึก กอง.สน.พร. ที่ กท.๐๕๒๙.๑๗/๓๘๗ ลง ๒ ส.ค.๖๗

๒. กบ.พร. ขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ ซื้อมาด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ฯ มีอายุใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี พร.กำหนดอายุใช้งานไว้ ๕ ปี เนื่องจากชำรุด หน่วยได้ประสานทางหุ้นส่วนสามัญ เค.ที.เมดิคอล มีเดีย เข้าซ่อมทำทางบริษัทฯ เสนอราคาซ่อม ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูง หน่วยจึงเสนอขอรับการซ่อมทำต่อ พร. ซึ่ง พร.ได้ให้ กอง.สน.พร. พิจารณาและดำเนินการพบว่า มีสภาพชำรุดมาก และมีอายุการใช้งานมานานเกินที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมทำ จึงเสนอขอยกเลิกการซ่อมทำตามข้อ ๑

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม

๓. ผอ.พร. พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ ครุภัณฑ์ดังกล่าว มีอายุใช้งานมานานเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถือว่าได้ใช้งานมาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแล้ว รวมทั้งมีสภาพที่ชำรุดมาก และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมทำ จึงสรุปวิธีที่จะซ่อมทำไว้ใช้ราชการได้ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการซ่อมทำตามที่ กอง.สน.พร. เสนอมา

๓.๒ เมื่อยกเลิกซ่อมทำแล้ว ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนหาเหตุการชำรุดและหาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แล้วรายงานให้ พร. ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ ยกเลิกการซ่อมทำครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑

๔.๒ ขอให้ รพ.อาคารเกียรติวงศ์ รพ.สส. ดำเนินการตามข้อ ๓.๒

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณานุมัติตามข้อ ๔

- อนุมัติตามข้อ ๔

รับคำสั่ง จก.พร.
พล.ร.ด.
รอง จก.พร. (๒)
ส.ค.๖๗

น.อ.

ทก.กบ.พร.

น.อ.

ทน.น.อ.พร.

๒๗.๘.๖๗



บันทึกข้อความ

พร. ๑๒๖๙๙/๖๗

กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ.....๕๓๕๕
วันที่.....- ๗ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....๑๒.๐๕

ส่วนราชการ กอง สน.พร. (แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ โทร. ๕๒๙๕๖)

ที่ กท ๐๕๒๙.๑๗/ กสพ

วันที่ ๖

ส.ค.๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกการซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

เสนอ พร.

๑. ตามที่ พร.ขอให้พิจารณาตรวจสอบและซ่อมเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป รายละเอียดตามบันทึก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐท.สส. ที่ กท ๐๕๒๑.๖/๑๔๕๐ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๗

๒. กอง สน.พร.ได้ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไปหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๔๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑ ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี พร.ได้กำหนดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ๕ ปี สภาพปัจจุบัน หลอดเอกซเรย์ชำรุด บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุด ในการนี้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐท.สส.ได้ประสานห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เมดิคอล มีเดีย เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำ ทางห้าง ฯ ได้เสนอราคาซ่อมทำเป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง กอง สน.พร.ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าในการซ่อมทำ

๓. กอง สน.พร.พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไปมีสภาพที่ชำรุดมาก และมีอายุการใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๕ ปี ตามข้อ ๒. ประกอบกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐท.สส.ได้ประสานห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เมดิคอล มีเดีย เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำ ทางห้าง ฯ ได้เสนอราคาซ่อมทำเป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง กอง สน.พร.ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าในการซ่อมทำ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะซ่อมทำให้สามารถใช้ในราชการได้ตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เห็นควรยกเลิกการซ่อมทำ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กอง สน.พร.

-ทพ.พร.
ชวลิตธน

ผนวก ก.

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำ

เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

ตราอักษร SHIMADZU

หมายเลขเครื่อง 3M 35262A1A013

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์

๒๔๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑

๑. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

$$๑.๑ \text{ สูตรความคุ้มค่า} = \frac{\text{ราคาตามสภาพปัจจุบัน}}{\text{ราคาซ่อมทำ}}$$

ถ้าผลลัพธ์ มีค่ามากกว่า ๑ แสดงว่า การซ่อมทำคุ้มค่า

ถ้าผลลัพธ์ มีค่าน้อยกว่า ๑ แสดงว่า การซ่อมทำไม่คุ้มค่า

๑.๒ อัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้แล้ว พร.กำหนดให้มีการคิดตามตารางอัตราค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ สาย พร. (อนุผนวก ๑ ของผนวก ก) และการปรับค่าของเงินตามช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งประเทศไทย จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (อนุผนวก ๒ ของผนวก ก) เป็นเกณฑ์ในการปรับตามบันทึกฯ สั่งการ ที่ ต่อ กบ.พร. (ลับมาก) เลขรับ ๙๔/๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำอุปกรณ์ของ พร. และที่ต่อ พร. เลขรับ ๑๙๔๗๗/๔๒

๒. การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

๒.๑ ชื่อเครื่อง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

๒.๑.๑ รับไว้ใช้ราชการเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ อายุการใช้งาน ๑๒ ปี

๒.๑.๒ ราคาซื้อ ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑.๓ ประวัติการซ่อมทำใหญ่ -

๒.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมทำปัจจุบัน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ มูลค่าของเครื่องในปีปัจจุบัน

๒.๒.๑ อัตราค่าเสื่อมราคา เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

ใช้แล้ว (พ.ศ. ปัจจุบัน - พ.ศ. ที่ได้มา) = ๑๒ ปี คิดเป็น ๗๘.๑๓ %

$$\text{มูลค่าของเครื่องที่เหลือ} = \frac{(๑๐๐ - ๗๘.๑๓ \times ๑,๙๖๕,๐๐๐)}{๑๐๐}$$

$$= ๔๒๙,๗๔๕.๕๐ \text{ บาท}$$

๒.๒.๒ ปรับราคาเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีปัจจุบัน = ๑๐๗.๒๒

- ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีที่ได้มา = ๙๒.๕๘

- ราคาตามสภาพปัจจุบัน = ดัชนีราคาผู้บริโภคปีปัจจุบัน x มูลค่าของเครื่องที่เหลือ

ดัชนีราคาผู้บริโภคปีที่ได้มา


$$= \frac{๔๙๗,๗๐๒.๖๖}{๑๐๐} \text{ บาท}$$

๓. สูตรการคำนวณความคุ้มค่า = ราคาตามสภาพปัจจุบัน / ราคาซ่อมทำ

$$= \frac{๔๙๗,๗๐๒.๖๖}{๘๗๐,๐๐๐.๐๐}$$

$$= ๐.๕๗$$

สรุปผลการซ่อมทำ = ซ่อมทำไม่คุ้มค่า

(ลงชื่อ) น.ต. 

(เศรษฐวิทย์ อัมศิริ)

ผู้ประเมิน

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ก
อัตราค่าเสื่อมราคายุทโธปกรณ์สายวิชาการ พร.

อัตราค่าเสื่อมราคา (คิดเป็น%ของราคาหักสต)			
อายุที่สูญปลายปีที่	ยุทโธปกรณ์ที่มีส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic)	ยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic)	เครื่องจักรคำนวณ (Computer)
๑	๗.๘๓	๑๕.๐๐	๑๕.๒๒
๒	๑๖.๕๔	๒๕.๐๐	๒๖.๑๓
๓	๒๗.๐๗	๓๕.๐๐	๓๗.๒๖
๔	๔๓.๗๕	๔๕.๐๐	๕๑.๗๑
๕	๕๑.๒๕	๕๕.๐๐	๖๔.๒๔
๖	๕๓.๗๒	๖๐.๐๐	๗๖.๖๑
๗	๖๘.๑๘	๖๓.๐๐	๘๖.๕๑
๘	๗๐.๗๕	๖๖.๐๐	๘๖.๕๖
๙	๗๕.๕๗	๖๘.๐๐	๘๘.๖๙
๑๐	๗๘.๑๓	๗๐.๐๐	๙๐.๗๐
๑๑		๗๐.๕๐	
๑๒		๗๑.๐๐	
๑๓		๗๑.๕๐	
๑๔		๗๒.๐๐	
๑๕		๗๒.๕๐	
๑๖		๗๓.๐๐	
๑๗		๗๓.๕๐	
๑๘		๗๔.๐๐	
๑๙		๗๔.๕๐	
๒๐		๗๕.๐๐	

หมายเหตุ-ยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์(MEC)ที่มีอายุการใช้งานเกิน๑๐ปีขึ้นไปให้เพิ่มอัตราค่าเสื่อมปลั๊๐.๕%

-ยุทโธปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในบางกรณีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้สูตรคำนวณอัตราเสื่อมราคาได้

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ก
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรวมทั้งประเทศ ปีฐาน ๒๕๖๒=๑๐๐

ปี พ.ศ.	ดัชนีราคาผู้บริโภค	ปี พ.ศ.	ดัชนีราคาผู้บริโภค
๒๕๓๗	๕๑.๑๐	๒๕๖๑	๙๘.๘๒
๒๕๓๘	๕๓.๖๐	๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐
๒๕๓๙	๕๗.๕๐	๒๕๖๓	๑๐๐.๑๓
๒๕๔๐	๖๐.๐๐	๒๕๖๔	๙๙.๗๙
๒๕๔๑	๖๕.๒๐	๒๕๖๕	๑๐๓.๐๑
๒๕๔๒	๖๗.๓๐	๒๕๖๖	๑๐๗.๘๖
๒๕๔๓	๖๗.๘๐	๒๕๖๗	๑๐๗.๒๒
๒๕๔๔	๖๘.๘๐		
๒๕๔๕	๖๙.๓๐		
๒๕๔๖	๗๐.๘๐		
๒๕๔๗	๗๑.๘๐		
๒๕๔๘	๗๓.๖๐		
๒๕๔๙	๗๔.๐๐		
๒๕๕๐	๘๐.๔๐		
๒๕๕๑	๘๓.๙๐		
๒๕๕๒	๘๓.๕๐		
๒๕๕๓	๘๖.๙๒		
๒๕๕๔	๘๙.๕๖		
๒๕๕๕	๙๒.๕๘		
๒๕๕๖	๙๕.๗๑		
๒๕๕๗	๙๗.๕๖		
๒๕๕๘	๙๗.๑๗		
๒๕๕๙	๙๖.๖๕		
๒๕๖๐	๙๘.๓๕		

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนพหลโยธิน 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ นก.พร. (กน. โทร. ๕๒๖๕๑)

ที่ ต่อ พร. เลขรับ ๑๒๖๙๙/๖๗

วันที่ ๖ ก.ค.๖๗

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

เรียน ทน.นฟอ.พร.

๑. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ขอรับการตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ของแผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.๗ จำนวน ๑ เครื่อง ทรานซิสเตอร์ SHIMADZU รุ่น/แบบ UD 150L-40E S/N 3M5262A1A013 ราคา ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับเมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ รหัสทะเบียนฯ ๒๔๖๐๐๘๐๔ - ๖๕๒๕๐๔๓ - ๐๐๐๑ ตามบันทึก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ที่ กท ๐๕๒๑.๖/๑๔๕๐ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๗

๒. กบ.พร. ตรวจสอบแล้ว ครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดซื้อด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.๗ มีอายุการใช้งานมาแล้ว ๑๒ ปี พร.กำหนดอายุใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ๕ ปี เนื่องจากชำรุดและไม่สามารถใช้ราชการได้ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ได้ให้เจ้าหน้าที่ช่างของ รพ.๗ ทำการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า เกินขีดความสามารถในการซ่อมทำ จากนั้นจึงเสนอขอรับการตรวจสอบและซ่อมทำต่อ พร. ตามข้อ ๑

๓. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ กอง สน.พร. ในฐานะหน่วยซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ ทร. เพื่อตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ทก.กบ.พร.

เสนอ กอง สน.พร. /

เพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

รับคำสั่ง จก.พร.

น.อ.

ทน.นฟอ.พร.

๖ ก.ค.๖๗

- ทราบ

- แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

พิจารณาดำเนินการ และรายงานให้ทราบ

น.อ.

รอง ผอ.กอง สน.พร. ทำการแทน

ผอ.กอง สน.พร.

๖ ก.ค.๖๗



พัฒนารักษณการกิจอ.ร.ร.
ส.อ.ม.พ.ย.
เลขรับ ๑๑๕/๘๗
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕๔๐

กองสนับสนุน พร.
เลขรับ ๑๒๕๖๕
วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕๐๗

กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ ๑๒๕๖๕
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕๑๕

บันทึกข้อความ

กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขรับ ๓๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐๓๓

ส่วนราชการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. (กน. โทร.๗๓๐๕๕)

ที่ กท.๐๕๒๑.๖/ ๑๔๕๐

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๗

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

เสนอ พร.

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส. ขอรับการสนับสนุนซ่อมทำเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป ตราอักษร SHIMADZU หมายเลขเครื่อง 3M85262A1A013 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๔๖๐๐๘๐๔-๖๕๒๕๐๔๓-๐๐๐๑ ใช้ราชการที่ แผนกรังสี กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ฯ เนื่องจากชำรุดใช้ราชการมานานไม่สามารถใช้ในราชการได้ โดยเจ้าหน้าที่ช่างของ รพ.ฯ ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเกินขีดความสามารถในการซ่อมทำ จึงขอรับการสนับสนุนจาก พร. ซ่อมทำครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อไว้ในราชการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

รอง ผอ.รพ.ฯ ทำการแทน

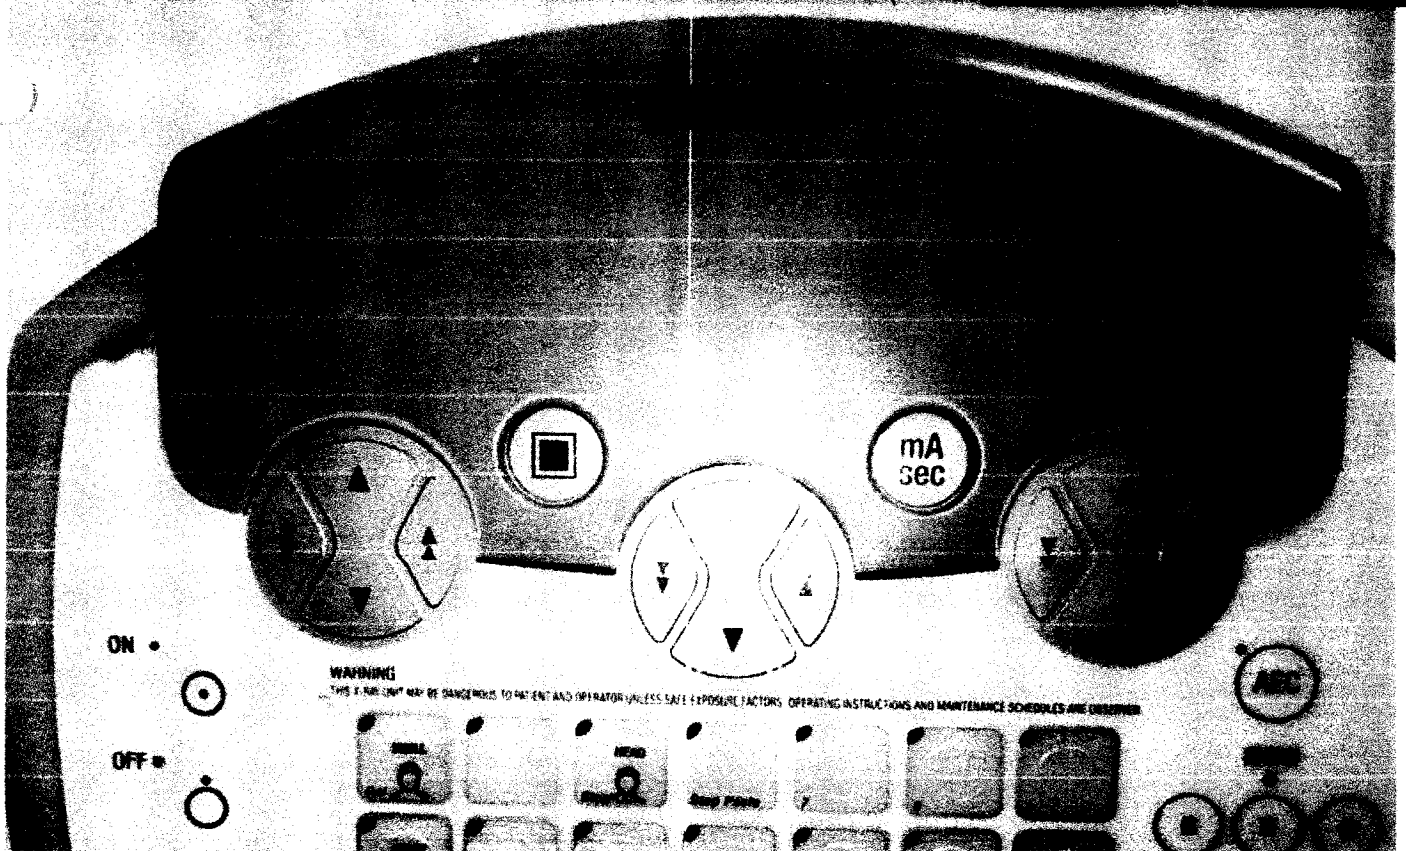
ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

ร.ร.
๑๒๕๖๕

โรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์ รุท.สส.

ชื่อ เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

หมายเลขทะเบียน 24600804-6525043-0001 คราอักษร SHIMADZU S/N 3M 35262A1A013



โรงพยาบาลอานาการเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

ชื่อ เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

หมายเลขทะเบียน 24600804-6525043-0001 ตราอักษร SHIMADZU S/N 3M 35262A1A013

24600804-6525043-0001

一般的名称
MODEL

据置型診断用X線発生装置

X-RAY HIGH VOLTAGE GENERATOR

販売名
医療機器の別
PN / SN
V, Hz, VA
RATED

診断用X線高電圧装置

管理医療機器

502-23374-50 /

~200/220/240, 50/60 Hz

125kV, 4mA

150kV, 200mA

60kV, 500mA

PROTECTION

MANUFACTURED

CLASS I

2011 Manufacturer

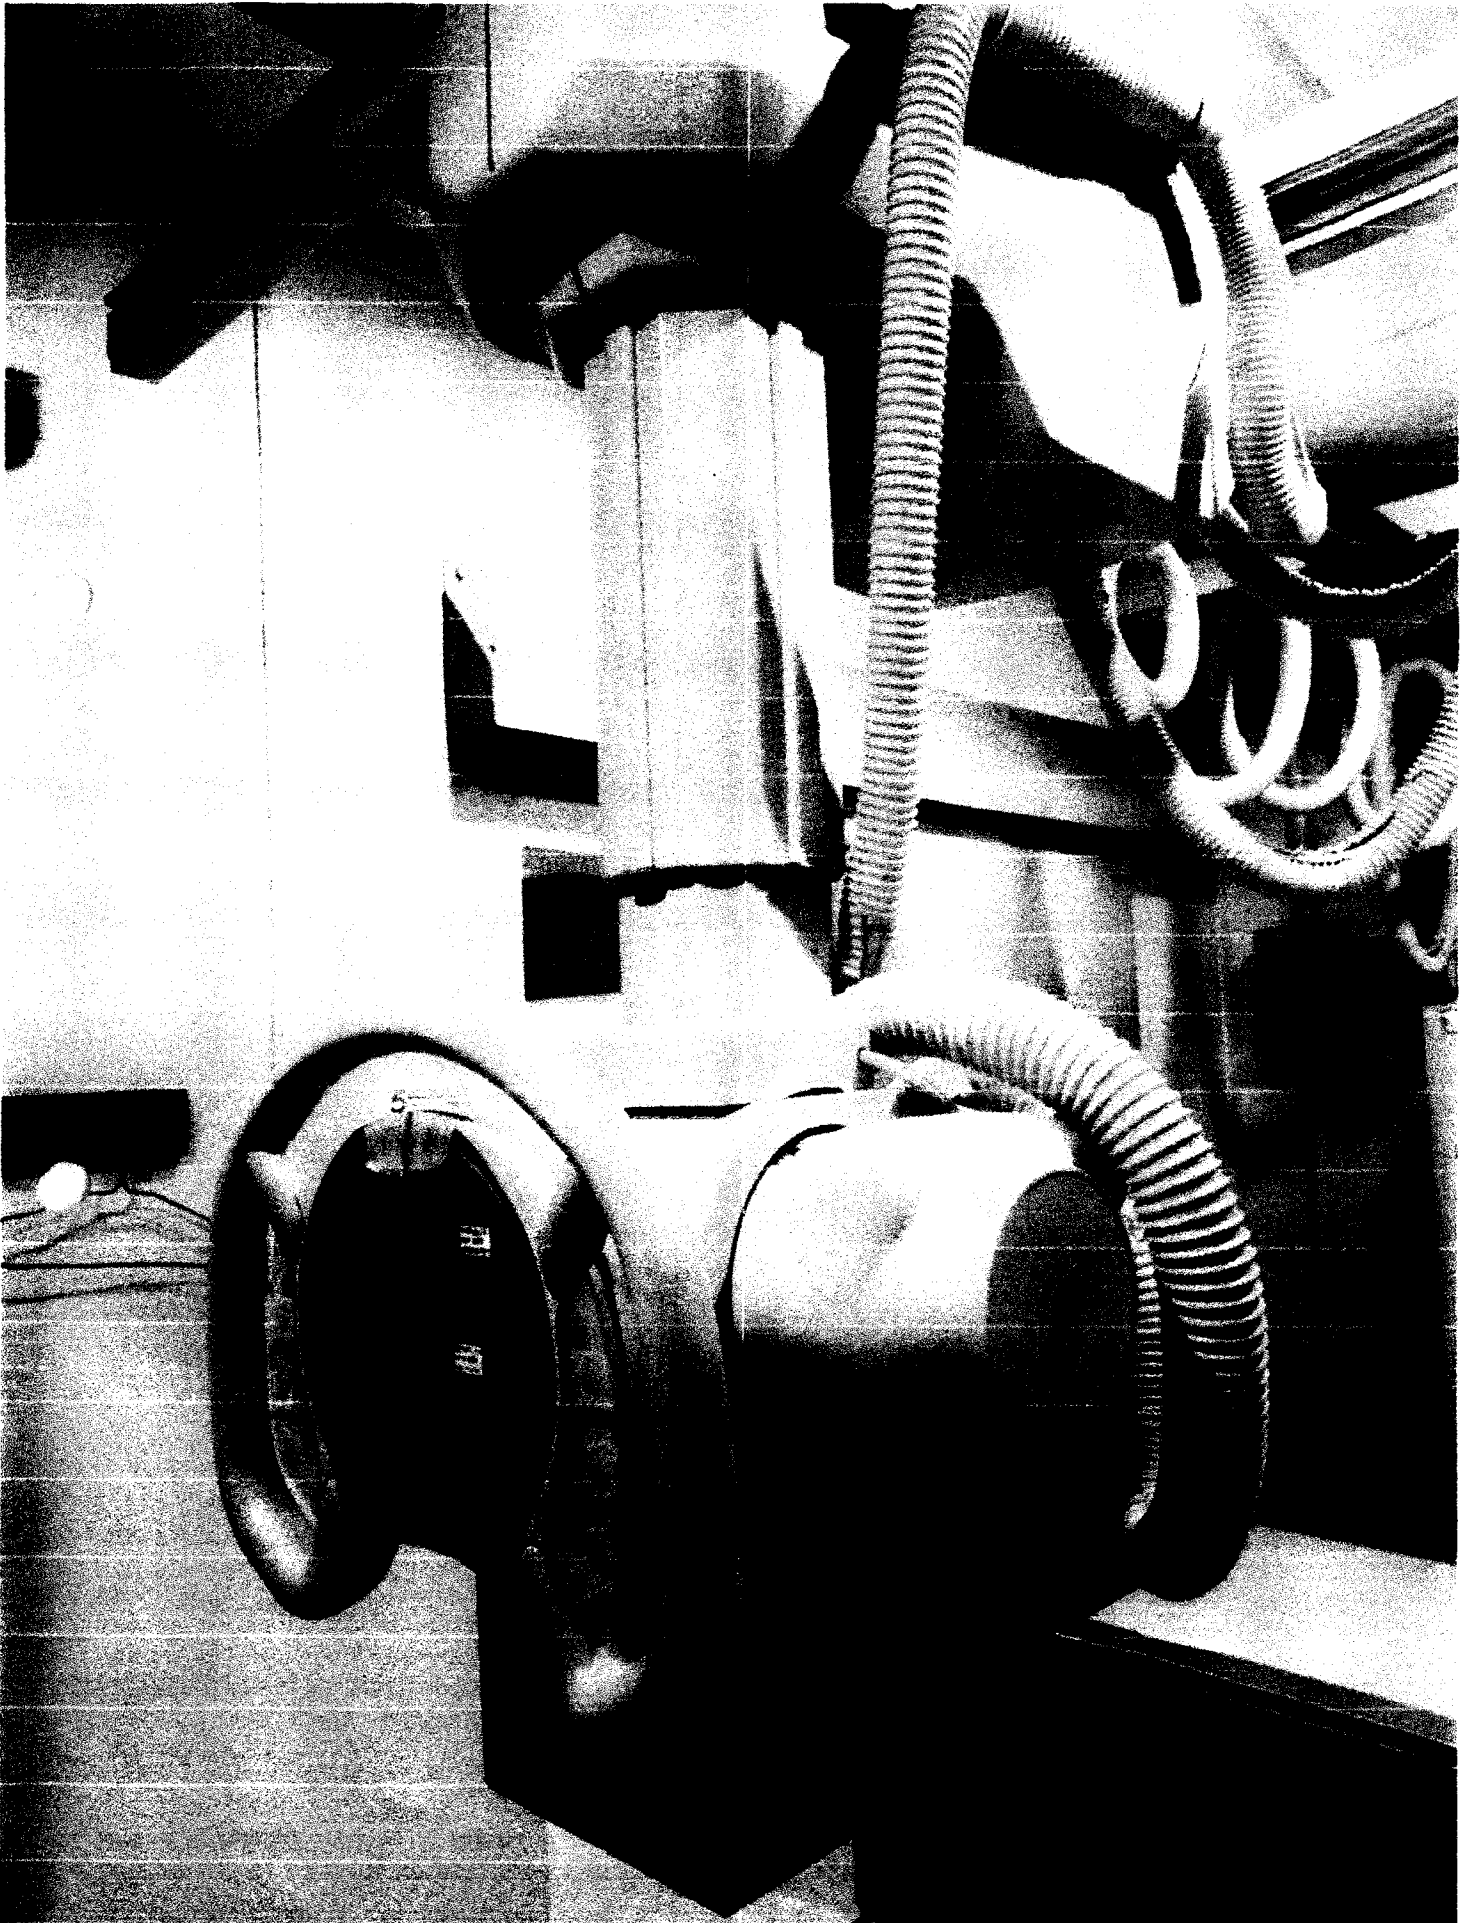


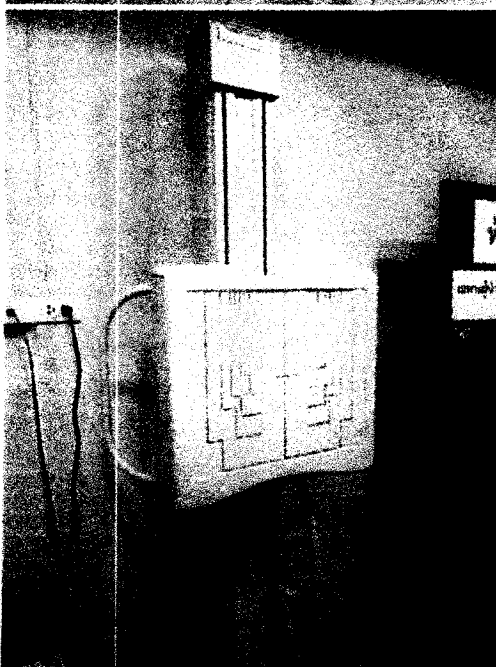
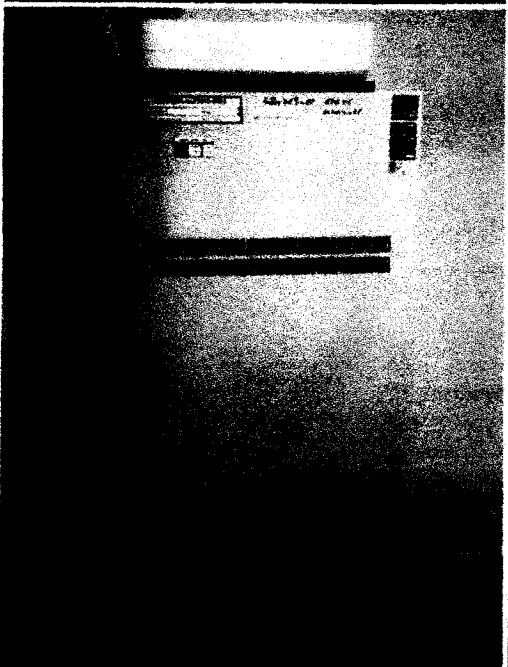
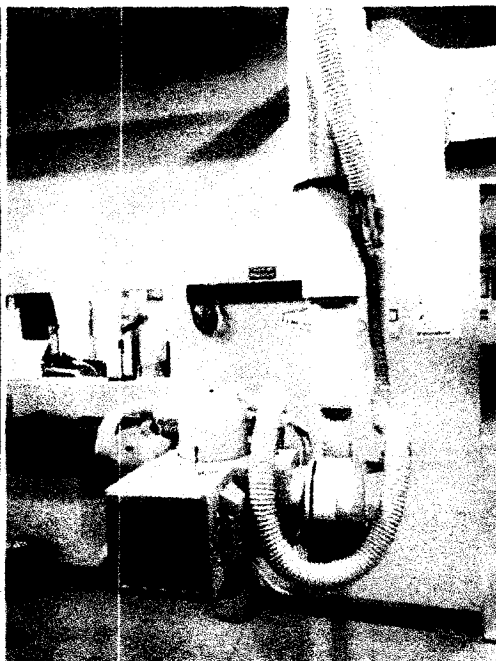
SHIMADZU

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ รฐ.สส.

ชื่อ เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป

หมายเลขทะเบียน 24600804-6525043-0001 คราอักษร SHIMADZU S/N 3M 35262A1A013







ประกาศกรมแพทยทหารเรือ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุทางการแพทย์ชำรุด

ด้วยกรมแพทยทหารเรือ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมี รายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. กำหนดการขายทอดตลาด วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทยทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการ เปิดรับลงทะเบียนแสดงความจำนงเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. กำหนดยื่นราคา ที่เสนอซื้อไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันขายทอดตลาด โดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๓. เงื่อนไขสำหรับผู้เสนอราคา

๓.๑ การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายเหมารวม จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา และ ต้องเสนอราคาเป็นเงินสดบาท ทั้งนี้ การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการขายทอดตลาดในตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด ไม่อนุญาตให้มีการมอบอำนาจในการเสนอราคา

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนแสดงความจำนงเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดในข้อ ๑ พร้อมทั้งวางเงินสดเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกัน การเสนอราคา โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ทางราชการจะคืนให้แก่รายที่มีได้รับการพิจารณาในโอกาสแรก ที่สิ้นสุดการดำเนินการขายทอดตลาดแล้ว ส่วนรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อนั้นจะยึดไว้เป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย และจะคืนให้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อขายแล้ว

๓.๓ ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินสดทันที หรือวางมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ และนำเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ประมูลได้ ที่กองการเงิน กรมแพทยทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อน แล้วจึงไปติดต่อขอรับและขนย้ายพัสดุชำรุดได้จากกองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทยทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าซื้อพัสดุครบถ้วน หากไม่ขนย้ายภายในเวลาที่กำหนดพัสดุนั้น จะต้องเป็นของทางราชการ

๓.๔ หากผู้เสนอราคารายใดที่ได้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเสนอราคาไว้ ถอนการเสนอราคาก่อนสิ้นสุดการดำเนินการขายทอดตลาด หรือผู้เสนอราคารายใดที่ชนะการประมูล ให้เป็นผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายตามข้อ ๓.๓ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางราชการ จะริบหลักประกันตามข้อ ๓.๒ และจะพิจารณาดำเนินการต่อผู้เสนอราคาดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป

๔. ขอสงวนสิทธิ กรมแพทย์ทหารเรือทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขายพัสดุชำรุดในครั้งนี้ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าผู้เสนอราคามีพฤติกรรมที่ไม่สมควรในการเสนอราคา อันจะทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์

๕. กำหนดตรวจดูพัสดุชำรุด ผู้สนใจจะเสนอราคาสามารถขอตรวจดูพัสดุชำรุดได้ที่ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (ในวันราชการ) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการพาดู

๖. ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๑๖ ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ (<https://www.nmd.go.th>)


ประกาศ

ณ

วันที่

๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

พลเรือโท




(ประทีป ตั้งติสานนท์)

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
รายการพัสดุทางการแพทย์ชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายบัญชีแล้ว

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	จำนวน
1	เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทั่วไป	เครื่อง	1
รวม		หน่วยนับ	1
ราคากลางที่กำหนด 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก 
(ธนชวัฒน์ ชัยกุล)
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ
กรมแพทย์ทหารเรือ
 เมษายน ๒๕๖๘